


九十九年度 CHT 確診醫院第二次 TSH 檢驗院際品管 統計分佈圖

送檢批號：CHT2010-09

檢體寄出日期：99年9月27日

報告截止日期：99年10月4日



回收份數(比率)：22份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	14.2	14.4 (10)	1.17	8.1%
03	11	11.1	11.0 (11)	1.09	9.9%
All	22	12.8	12.6 (21)	2.07	16.4%


* Outlier not included.




檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	5.5	5.6 (9)	0.29	5.3%
03	11	3.7	3.9 (11)	0.41	10.7%
All	22	4.5	4.6 (21)	0.93	20.3%

* Outlier not included.




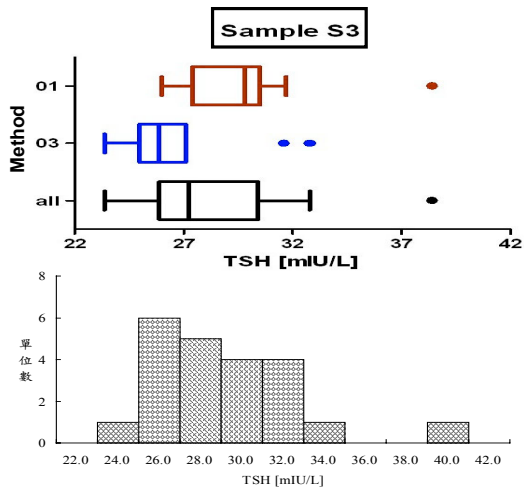

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	29.8	29.0 (10)	1.78	6.1%
03	11	25.9	25.7 (9)	1.15	4.5%
All	22	27.3	27.9 (21)	2.59	9.3%


* Outlier not included.



檢體 S4

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	5.4	5.6 (10)	0.38	6.7%
03	11	4.0	3.9 (11)	0.42	10.8%
All	22	4.4	4.7 (22)	0.93	19.8%

* Outlier not included.

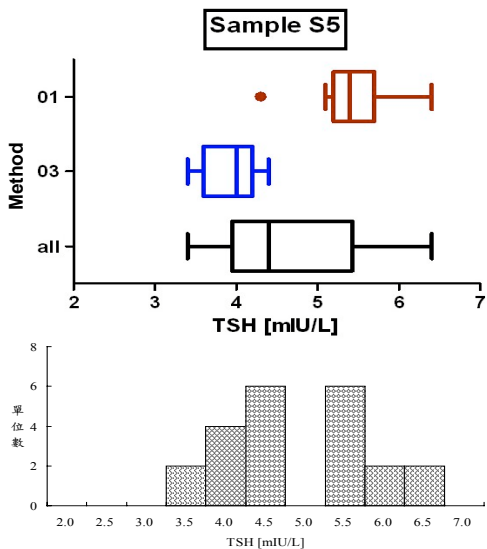

檢體 S5

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	5.4	5.6 (10)	0.40	7.2%
03	11	4.0	3.9 (11)	0.36	9.0%
All	22	4.4	4.7 (22)	0.91	19.2%

* Outlier not included.